


【骨盤補整ニッパ-の着用方法】

【基本編】

①ウエスト部分の一番細い所で、骨盤ベルトのホックをとめて、ファスナーを半分まで上げます。次に、骨盤の位置までおろして、ファスナーを全部しめます。

②しっかりとお腹押さえができるように位置を調節して、中心を合わせます。

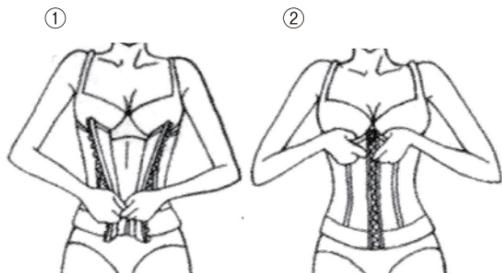


【らくらく編】

①着用する前に内側のベルトのホックとファスナーを半分位まで上げた状態にしてから下から履きます。


②そのまま骨盤の位置まで上に持ち上げ、ファスナーを全部しめて、中心を合わせます。

ご注意

生地を持たずに、コイルボン部分をもち、上に上げて下さい。(生地が破損する恐れがあります。)

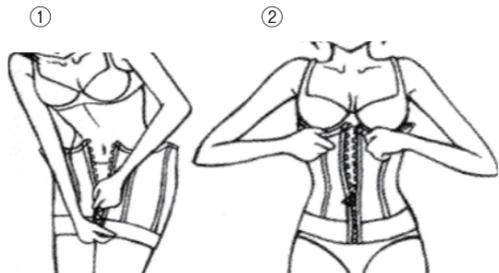

【ウォーキングスパッツの着用方法】

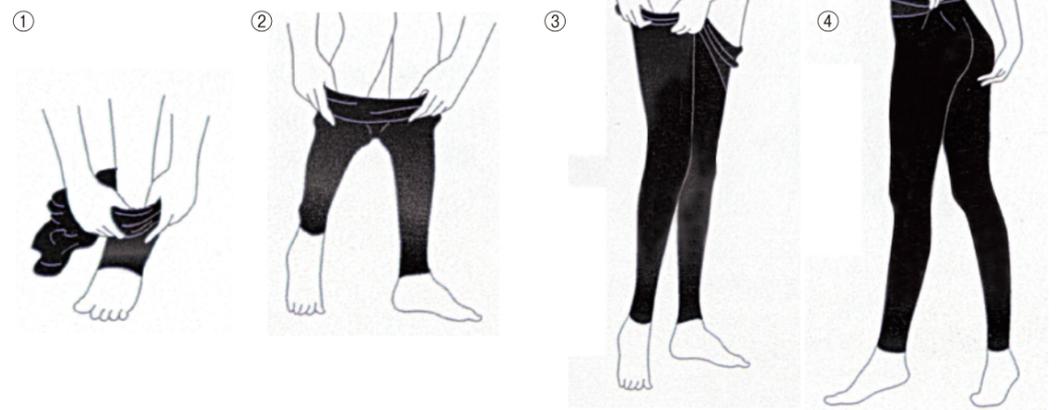

●ウエスト計測

ヒジを曲げたとき下に来る部分がウエストになります。床面に対して水平になるように計測してください。

【骨盤補整ニッパ-】 カラー:ブラック メーカー希望小売価格 ¥154,000 (税込)

表記	70	76	82	90	98	106	114	122	130
ウエスト	67~73	73~79	78~86	86~94	94~102	102~110	110~118	118~126	126~134
ヒップ	86~96	89~99	91~103	94~106	97~109	100~112	103~115	106~118	109~121

【ウォーキングスパッツ】 カラー:ブラック メーカー希望小売価格 ¥140,800 (税込)

表記	64	70	76	82	90	98	106
ウエスト	61~67	67~73	73~79	78~86	86~94	94~102	102~110
ヒップ	83~93	86~96	89~99	91~103	94~106	97~109	100~112

※上記サイズ表は、あくまで目安です。補整下着ですので、多少の圧迫感がございます。また、人それぞれ骨格・肉質・着け心地等がありますので、上記表にとらわれず、試着をされる事をお勧めします。ニッパ-を着けはじめの方は、サイズ表よりワンサイズ上をお勧めします。例)ウエスト75の方なら、82サイズをお勧めします。

加圧を利用した商品の使用上の注意

- 1.重度の血行障害がある方は使用しないでください。
- 2.次の方は着用前に医師にご相談ください。糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うつ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方。
- 3.着用にあたり、次のことに注意してください。
(1)サイズが合わないものや2枚重ねでの着用はしないでください。
(2)使用中にしわやたるみができないようにしてください。
(3)ひざ下、ひざ裏で生地が丸まらないように伸ばしてください。
(4)就寝時の着用はしないでください。
- 4.気分が悪くなったり、痛みやしびれなどの不快感、かゆみ、発疹等異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 5.着用時間に制限はありません(就寝時は除く)。
- 6.製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管をしないでください。
- 7.妊婦の方は使用しないでください。



商品販売元:株式会社優越館
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町5-6-32 優越ビル2F

健康で若々しい
ラインをめざして。

Body Make

骨盤補整ニッパ- &
ウォーキングスパッツ

YUETSUKAN